

Nieuwe instellingen inlezen voor de SafetyPAT 3140.



LET OP!

Met het laden van nieuwe instellingen wordt de tester terug gezet naar fabrieksinstellingen!
Klant specifieke aanpassingen verdwijnen hierdoor!
Een back-up van de Instellingen voor aanpassen is wenselijk.

In december 2018 (verder aangevuld in juli 2019) heeft de NEN een nieuwe versie van de NEN 3140 uitgebracht.

Om aan te sluiten bij de laatste versie van deze NEN 3140 norm heeft Nieaf Smitt voor de SafetyPAT 3140 nieuwe meetinstellingen beschikbaar.

De aanpassingen in de meetinstellingen hebben voornamelijk betrekking op het keuren van gearde objecten. Hierdoor zullen nieuwe testprogramma's gebruikt moeten worden ter vervanging van de "oude". Lees hiervoor de instructie : ["Herkeur met NEN3140 2018 instellingen SafetyPAT 3140 NIEUWE FW"](#)

Onderstaand vind u een beschrijving u de instellingen kunt inlezen op uw SafetyPAT 3140.

Wabtec Netherlands B.V. - Darwinstraat 10 - 6718 XR Ede - The Netherlands - Tel +31 (0)342 403 900 - www.wabtec.nl
VAT: NL 856195212B01 - Chamber of Commerce: 65631668

Location Utrecht: Vrieslantlaan 6 - 3526 AA Utrecht - The Netherlands - Tel +31 (0)30 288 1311 - www.morssmitt.com - sales.msbv@wabtec.com
IBAN: NL94ABNA0633047155 - BIC: ABNANL2A

Indien de huidige instellingen bewaard dienen te worden, volg eerst de instructies, die nu volgen!


Nieuwe instellingen inlezen met een Safetypat 3140.



Back-up maken van instellingen vóór het laden van de nieuwe versie.

Om een reserve copy van de instellingen te maken dienen de onderstaande stappen te worden genomen.

Stap 1: Plaats een lege USB schijf in de tester



Stap 2: Selecteer via het scherm verzenden de optie “Kopieer Instellingen” met “USB stick”




15/03/19 09:59:52  admin  0



SafetyPAT 3140 Uitvoer

met :-

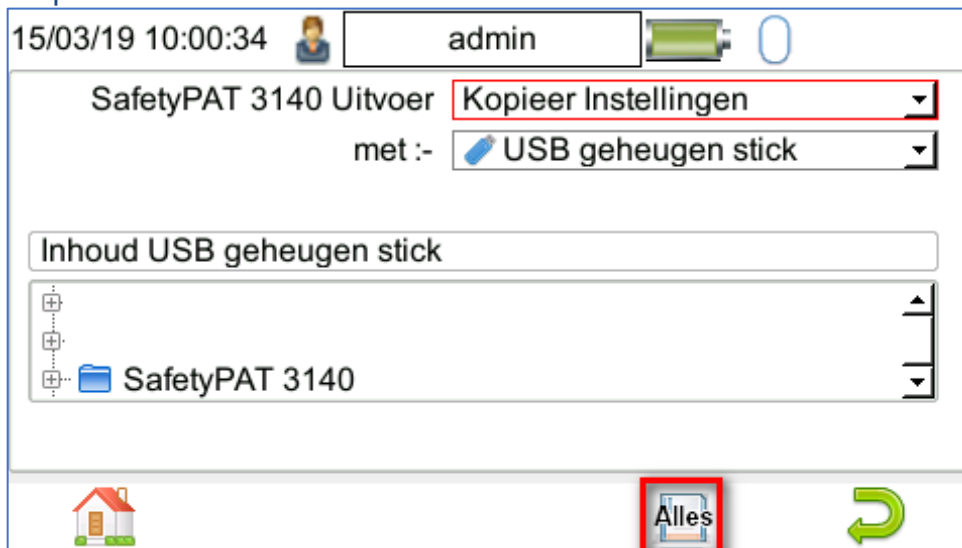

Stap 3: Plaats een USB stick






15/03/19 10:00:34  admin  0

SafetyPAT 3140 Uitvoer

met :-

  SafetyPAT 3140

Stap 4: Sla het configuratiebestand op via F4 “Alles”.

Hierna kunt u de USB schijf verwijderen.

Nieuwe instellingen inlezen met een Safetypat 3140.

Stap 1: Download het instellingen bestand “default-settings-nen3140-2019-15-30ma-110619.tar” via de volgende link: [NEN 3140:2018 instellingen](#)

Stap 2: Zet dit bestand op een lege USB geheugen stick.

Stap 3: Opstarten van de Safetypat 3140



Stap 4: Keuze instellingen menu (F4)




Nieuwe instellingen inlezen met een Safetypat 3140.

Stap 5: Instelling menu



Stap 6: Keuze Ontvangen (7)

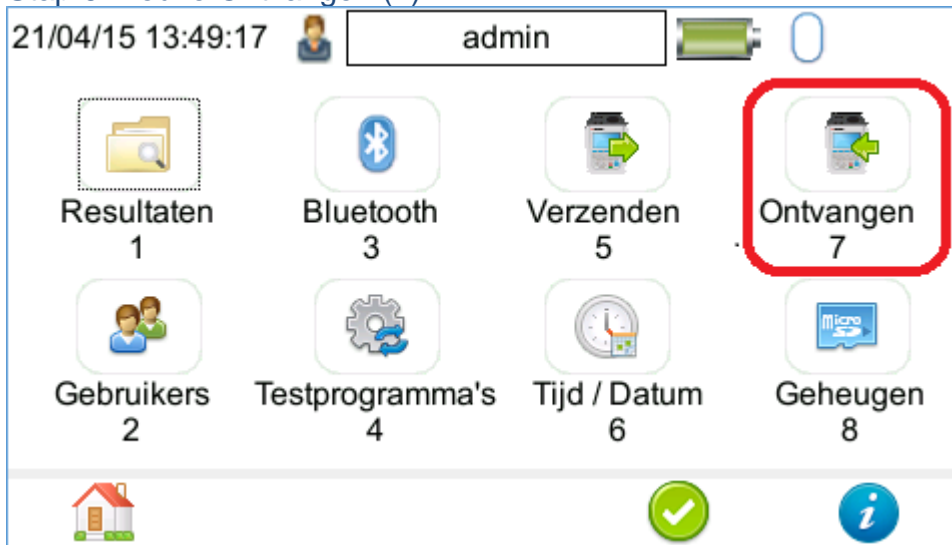

Nieuwe instellingen inlezen met een Safetypat 3140.

Stap 7: Ontvangst instellingen tijdelijk wijzigen.

06/11/15 12:36:38  admin  0

SafetyPAT 3140 Invoer **Uit PATManager** 

met-  USB-PC kabel 

Bewaren gegevens naar SafetyPAT map, druk op F3 indien gereed

Stap 8: “Uit PATManager” wijzigen in “Inlezen Instellingen”.

06/11/15 12:36:38  admin  0

SafetyPAT 3140 Invoer **Uit PATManager**  

met-  USB-PC kabel 

Bewaren gegevens naar SafetyPAT map, druk op F3 indien gereed

Nieuwe instellingen inlezen met een Safetypat 3140.

Stap 9: Met:- “USB-PC Kabel” wijzigen in “Geheugen stick”.

06/11/15 12:36:38  admin  0



SafetyPAT 3140 Invoer

met:- 

Bewaren gegevens naar SafetyPAT map, druk op F3 indien gereed




Stap 10: Ontvangen met de Geheugen stick.

15/03/19 10:01:14  admin  0

SafetyPAT 3140 Invoer


met:-

Data bestanden van USB stick OK. Selecteer een bestand en druk op F4.

Stap 11: Bevestigen op de SafetyPAT 3140 met F4

Stap 12: Na inlezen wordt de volgende melding gegeven:

 **Kopieren geslaagd, tester uitschakelen**

Bevestig met enter en start de tester opnieuw op, waarna de nieuwe instellingen geladen worden.